



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
40-038 Katowice, ulica Powstańców 31
www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26
sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 7512 /2025

Katowice, dnia 27.10.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 –


Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” – Nr referencyjny: ZP/D/14/25.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 2 – ZAŁĄCZNIK NR 2A, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, UWAGA pkt 10:

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu integracji z LIS oraz zapewni dostęp do Internetu? Oferowane analizatory i systemy wymagają stałego połączenia z Internetem, które umożliwia aktualizację licencji oprogramowania, pobieranie danych dotyczących odczynników, kontroli, kalibratorów, serwis zdalny. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na sprecyzowanych portach w poniższej tabeli. Poniżej znajduje się poglądowy schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rin-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

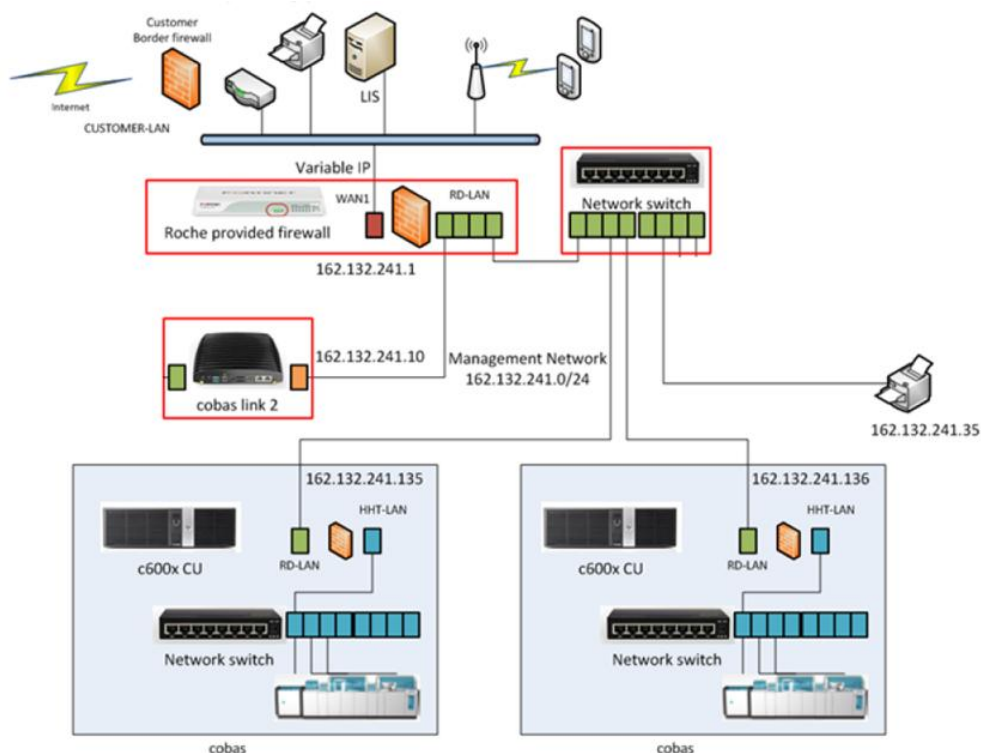

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udostępni dostęp urządzenia do sieci lokalnej. Zamawiający zapewni dostęp przez Internet tylko dla wymaganych usług na określonych portach.

Pytanie 2: Dotyczy Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

par. 1 ust. 4 Wykonawca przewiduje podpowierzenie danych osobowych. W związku z tym, prosimy o dodanie w umowie następującego postanowienia:

„Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Wykonawca jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1. Lista ta może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis w Załączniku Nr 11 *Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych* wg. załączonego skorygowanego Załącznika Nr 11.

Pytanie 3: Dotyczy Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

par. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis w Załączniku Nr 11 *Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych* wg. załączonego skorygowanego Załącznika Nr 11.

Pytanie 4: Dotyczy treści SWZ:

SWZ III 1b. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentu zawierającego Instrukcje wykonania oznaczeń / odczytu / Metodyki opis produktu / informację / folder / kartę katalogową w języku polskim w wersji elektronicznej – dotyczy materiałów wyszczególnionych w Tabeli D Formularza asortymentowo-cenowego – jeżeli producent nie przygotował takich materiałów – dotyczy materiałów zużywalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści złożenie przez Wykonawcę dokumentu/ oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków SWZ dla niektórych materiałów zużywalnych wyszczególnionych w Tabeli D Formularza asortymentowo – cenowego- Załącznik nr 2A, jeżeli producent nie przygotował takich dokumentów

Pytanie 5: Dotyczy treści SWZ:

W związku z brakiem wymogu zaoferowania stołu pod oferowany analizator prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora wolnostojącego podłogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 6: Dotyczy treści SWZ:

W związku z wymogiem SWZ "Analizator o wydajności nie mniejszej niż 600 oznaczeń na godzinę / z ISE/." Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna wydajność części fotometrycznej analizatora nie powinna być mniejsza niż 400 oznaczeń na godzinę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, całkowita wydajność analizatora nie mniejsza niż 600 oznaczeń na godzinę wraz z ISE.

Pytanie 7: Dotyczy treści SWZ:

W związku z wymogiem zaoferowania „analizatora w pełni automatycznego” prosimy o potwierdzenie, że analizator powinien być wyposażony w automatyczny podajnik próbek, w którym próbki wstawiane są w dedykowanych statywach w dowolnym momencie pracy aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał dokładanie prób badanych w trakcie pracy analizatora, jednocześnie nie określa sposobu ich podawania.

Pytanie 8: Wzoru treści SWZ:

Czy wymóg „Analizator umożliwiający priorytetowe wykonanie próbek pilnych z możliwością ich zlecenia w dowolnym momencie” oznacza, że analizator powinien być wyposażony w automatyczny podajnik próbek, w którym próbki wstawiane są do podajnika w statywach i podajnik wyposażony jest w dedykowane miejsca do wstawiania statywów z próbkami pilnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie określa sposobu i miejsca podawania próbki pilnej do analizatora.

Pytanie 9: Dotyczy treści SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 10 SWZ spełnia analizator, który wyposażony w detektor skrzepu z funkcją powiadomienia o tym operatora, i igła próbkowa pomiędzy dozowaniem poszczególnych próbek igła próbkowa jest płukana od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną w studzience do mycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie określa sposobu płukania igły pobierającej, Zamawiający określa jedynie, że ma być to proces automatyczny, bez udziału operatora

Pytanie 10: Dotyczy treści SWZ:

W związku z wymogiem, aby analizator umożliwiał stałe przechowywanie odczynników na pokładzie (punkt 12 SWZ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby karuzela odczynnikowa umożliwiała jednoczesne umieszczenie na pokładzie minimum 50 zestawów odczynnikowych. Takie rozwiązanie umożliwi jednoczesne umieszczenie na pokładzie wszystkich odczynników wymienionych w SWZ łącznie w części zdublowanych odczynników, aby zapewnić płynne kontynuowanie pracy z nowego opakowania po zużyciu jednego opakowania odczynnika w trakcie serii badań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników, jednocześnie nie określa ilości zestawów umieszczonych w tym samym czasie na pokładzie analizatora.

Pytanie 11: Dotyczy treści SWZ:

W związku z wymogiem punktu 26 SWZ – „Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody (uwzględniając zużycie wody konieczne do funkcjonowania analizatora, mycia, płukania rozcieńczania płynów, etc. o wymaganej jakości wody). Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby analizator pracował w oparciu o kule wielorazowe myte na pokładzie analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące: Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody (uwzględniając zużycie wody konieczne do funkcjonowania analizatora, mycia, płukania rozcieńczania płynów, etc. o wymaganej jakości wody). Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania”. Zamawiający w wymaganych parametrach analizatora nie określa rodzaju kulek.

Pytanie 12: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość przechowywania kalibratorów, kontroli i próbek pilnych w chłodzonej karuzeli, izolowanej od światła na pokładzie aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby oferowany analizator miał możliwość przechowywania kalibratorów, kontroli i próbek pilnych w chłodzonej karuzeli, izolowanej od światła na pokładzie aparatu.

Pytanie 13: Wzoru treści SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatorów zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody

referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku jeżeli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, to nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody.

Pytanie 14: Dotyczy treści SWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania, oszacowania i zaoferowania odpowiedniej ilości przedmiotu zamówienia, wystarczającego na cały okres trwania umowy tj. 36 miesięcy.

Pytanie 15: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnik.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie w zakresie pakietu Nr 2.

Pytanie 16: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator, odczynniki stanowiły spójny system analityczny i produkowane były przez jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 17: Dotyczy treści SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że analizator, w którym odczynniki dokładane bez przerywania pracy analizatora w trybie „wstrzymania odczynnika” podczas, którego operator uzyskuje dostęp do karuzeli odczynnikowej, gdzie przez specjalne okno możliwe jest dostawianie odczynników, bez konieczności zatrzymywania pracy aparatu i bez konieczności otwierania pokrywy głównej przedziału odczynnikowego, spełnia wymagania zdefiniowane w punkcie 22 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał dokładanie odczynników bez przerywania pracy analizatora, jednocześnie Zamawiający nie określa trybu pracy analizatora podczas, którego operator uzyskuje dostęp do karuzeli odczynnikowej.

Pytanie 18: Wzoru treści SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi dla analizów raportowanych do NFZ w ramach kontroli COBJwDL istniała grupa metodyczna minimum 50 użytkowników pracujących na oferowanych odczynnikach i rodzinie, do której należy oferowany analizator.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19: Dotyczy treści SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie wymogu parametru ocenianego – „Analizator umożliwia automatyczne flagowanie wyników testów fotometrycznych i ISE, na które wykryta interferencja (ikteria, lipemia, hemoliza) ma wpływ” i potwierdzenie, że flagowanie to powinno pojawiać się jedynie przy parametrach, na które wpływa dana interferencja.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. „Analizator umożliwia automatyczne flagowanie wyników testów fotometrycznych i ISE, na które wykryta interferencja (ikteria, lipemia, hemoliza) ma wpływ.”

Pytanie 20: Dotyczy Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21: Dotyczy Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu dla obsługi serwisowej.? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie analizatorów do usługi bezpośredniego zdalnego dostępu dla obsługi serwisowej, umożliwi jedynie dostęp dla urządzenia zewnętrznego do realizacji takiej obsługi.

– W Z Ó R –

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nr ZWPS/DA/...../202...

Zawarta w dniu202... roku w Katowicach (zwana również „Umową”) pomiędzy:

Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057698, NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382, w imieniu, którego działa:

Dyrektor – lek. med. Jacek Przybyło

zwanym dalej również „**Udzielającym Zamówienia**”

a

.....
z siedzibą:

NIP: REGON:

który reprezentuje:

1.
2.

zwanym/ą w dalszej części niniejszej Umowy „**Przyjmującym Zamówienie**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że strony zawarły umowę nr **ZWPS/DA/ ... / 202...**, na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora, w celu jej wykonania Przyjmujący Zamówienie będzie dokonywał określonych operacji na danych osobowych.

Udzielający Zamówienia jako Administrator Danych, zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 26 kwietnia 2016r (zwanym dalej rozporządzeniem), zamierza powierzyć Przyjmującemu Zamówienie przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Przyjmujący Zamówienie będzie administrował danymi osobowymi powierzonymi mu przez Udzielającego Zamówienie dla celów wykonania umowy.
2. Udzielający Zamówienia powierza do przetwarzania dane osobowe, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z Umową, rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Danymi osobowymi podlegającymi przetworzeniu w szczególności są :
 - a) imię i nazwisko;
 - b) numer PESEL;
 - c) oznaczenie pćci;

- d) data urodzenia;
- e) adres zamieszkania /oddział szpitalny;
- f) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania opiekuna osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej;
- g) rozpoznanie choroby;
- h) inne dane konieczne do realizacji badania, leczenia lub diagnostyki.

Powyższe dane dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w realizację umowy, tak Pacjentów jak i Personelu ZWPS.

- 4. **Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Wykonawca jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1. Lista ta może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody. Wykaz / listę podmiotów podprzetwarzających dane osobowe, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.**
- 5. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Przyjmującego Zamówienie. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.
- 6. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie za działanie osób trzecich, którym Przyjmujący Zamówienie zlecił wykonanie umowy w jakimkolwiek zakresie.

§ 2

Na podstawie Umowy Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w ramach Zlecenia tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Zlecenia (zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy).

§ 3

- 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2, zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
- 2. Przyjmujący Zamówienie przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wdrożyć adekwatny do poziomu ryzyka System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- 3. Przyjmujący Zamówienie może wykonywać Zlecenie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Udzielającego Zamówienie.
- 4. W przypadku korzystania także z innych urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, niż wskazane w zdaniu poprzednim, będących własnością Przyjmującego Zamówienie, znajdujących się w jego posiadaniu oświadcza on, iż spełniają one wymogi prawne celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
- 5. Przyjmujący Zamówienie każdorazowo poinformuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 7 dni, Udzielającego Zamówienia o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Udzielającego Zamówienia lub Przyjmującego Zamówienie na podstawie przepisów związanych

z ochroną danych osobowych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

§ 4

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:
 - a) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze lub zbieranych w celu włączenia do Zbioru;
 - b) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich;
 - c) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do Zbioru osobom nieupoważnionym.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
 - a) poinformować o tym Udzielającego Zamówienia – Administratora Danych, poprzez zawiadomienie Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora Danych oraz kierownictwo Udzielającego Zamówienia, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia;
 - b) ustalić przyczynę naruszenia;
 - c) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
 - d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.
2. Udzielający Zamówienia ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Przyjmującego Zamówienie przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest pisemne zawiadomienie Przyjmującego Zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Przyjmującemu Zamówienie.
5. Przyjmujący Zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, także u Podwykonawców Przyjmującego Zamówienie, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u podmiotów, którym powierzył czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.
7. **Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.**

- a) **Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.**
- b) **Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę.**
- c) **Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.**

§ 6

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, które zasięgnęli w trakcie trwania Umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że druga strona zwolni ich z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiąże pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania w poufności, w ramach tajemnicy służbowej, wszelkich informacji lub danych osobowych, do których mogą mieć dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych jak również do nie ujawniania stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń lub upewni się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§ 7

1. Udzielający Zamówienia oświadcza, że Inspektorem Ochrony Danych u Udzielającego Zamówienia na dzień podpisania Umowy jest: Zbigniew Łata, sekretariat@zwps.pl, (32) 343-41-01.
2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jako Administrator Danych, osobiście wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych, a nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie Przyjmującego Zamówienie na dzień podpisania Umowy pełni: Pan /Pani

§ 8

Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub niniejszej Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć bezpowrotnie dane osobowe oraz inne informacje, których przetwarzanie na podstawie niniejszej Umowy zlecił mu Udzielający Zamówienia, o ile przepis prawa obowiązującego nie stanowi inaczej.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy określonej w Preambule i wygasa automatycznie z chwilą jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
2. Strony postanawiają, że we wszelkich sprawach nie objętych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę powoda.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE